



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ

Клиническая больница»

W.A.Мирзонов

Червон 2012 года

Протокол № 35/03/12

**О проведении медицинских испытаний изделия медицинского назначения
далее ИМН Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО, в комплектации
(см. приложение) ТУ 9444-001-65178795-2011
ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМН ООО НПО «Свитозар», РФ, 124482, г.
Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, пом. VII, ком. 15**

Цель испытания - оценка возможности применения Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО (далее аппарат) в медицинской практике лечебных учреждений и в домашних условиях на территории Российской Федерации.

Основание для проведения испытаний:

- письмо ООО НПО «Свитозар» от 16.01.2012г. № 14 ,
 - протокол токсикологических испытаний № 7449.011 от 20.09.11г., № 7777.011 от 03.10.11г.
 - протокол технических испытаний №№ 18/Б-045/11МТ, 18/Э-102/11МТ от 17.10.11г
 - комплект документов на изделие, включающий: руководство пользователя, ТУ 9444-001-65178795-2011, иллюстративные материалы.
 - образец изделия.

Медицинские испытания заключалась в изучении научно-практической документации, изучении воздействия аппарата на пациентов с целью определении возможности применения ИМН в медицинской практике.

Этапы испытаний

- изучение документации;
 - изучение научно-практической информации по указанным вилам воздействия на человека;
 - проверка работы изделия в практике;
 - анализ результатов о рекомендаций по применению аппарата

Сфера применения, показания

Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО

профилактики и лечения различных заболеваний, в том числе пятончая шпора; артриты; артрозы; реабилитация после хирургического вмешательства.

Противопоказания

- беременность;
- эпилепсия;
- наличие имплантируемого кардиостимулятора;
- некомпенсированная гипертония;
- индивидуальная непереносимость электрического тока.

Клинический обзор:

В период с 17.01.2012г. по 27.02.2012г. в Мытищинской городской клинической больнице были проведены медицинские испытания Аппарата физиотерапевтического МАГ БИО, в комплектации.

Для проведения медицинских испытаний отбирались пациенты, которых ознакомили с принципом действия аппарата и получили согласие на использование аппарата.

Во время испытаний изучались результаты применения аппарата заявленным характеристикам. Пациенты опрашивались для оценки результатов и отрицательных ощущений.

Целью испытаний являлось определение эффективности и безопасности применения ИМН: Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО, в комплектации

Программа испытаний включала:

- Выявление лечебных эффектов
 - Определение показаний к проведению лечебных процедур
 - Выявление и оценка нежелательных побочных эффектов при проведении процедур.
 - Оценка эксплуатационно-функциональных особенностей аппарата модели
- Исследования были проведены на 12 пациентах (7 женщин, 5 мужчин в возрасте от 32 до 65 лет) со следующими основными диагнозами:
- переломы конечностей с ушибами -5чел,
 - артрозы коленного сустава - 4 пациента,
 - артроз голеностопного сустава-2 чел

Продолжительность каждой процедуры составляла 5-7 мин, процедуры проводились ежедневно или через день. Курс лечения составлял до 5 – 10 процедур. В результате испытаний выявлены следующие основные лечебные эффекты:

- снижение болевого синдрома,
- противовоспалительный эффект,
- противоотечный эффект.

Побочные эффекты: при соблюдении правил проведения лечебных процедур наблюдалась в некоторый случаях нестойкая гиперемия облучённой поверхности кожи. Других побочных эффектов не наблюдалось.


Заключение:

В результате испытаний выявлены следующие эксплуатационные и функциональные особенности аппарата:

- Представленная для клинических испытаний модель соответствует представленной технико-эксплуатационной документации.
- Представленный аппарат прост, удобен и надёжен в обращении и управлении.

Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО, в комплектации может быть с успехом использован для лечения и профилактики в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, спортивно-оздоровительных центрах и в домашних условиях при консультации с врачом. Поверхность аппарата легко дезинфицируется. По результатам клинических испытаний Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО, в комплектации соответствует своему назначению и может быть рекомендован для регистрации и применения в медицинской практике на территории Российской Федерации.

Руководитель испытаний:

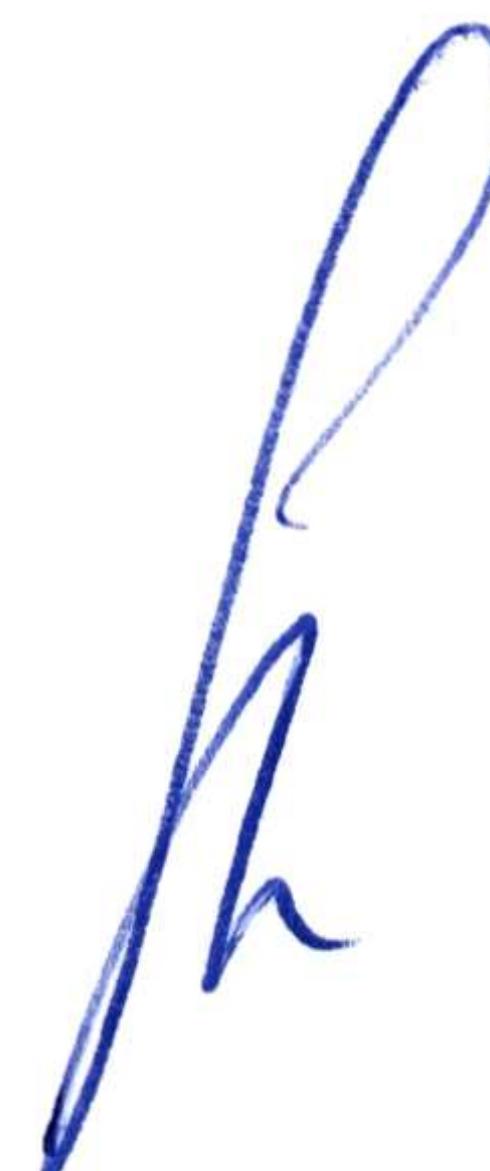

Артемьев А.А.

Приложение 1 к протоколу для регистрации ИМН:

Аппарат физиотерапевтический МАГ БИО, в исполнении: МАГ БИО-01, МАГ БИО-02 (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 9444-001-65178795-2011)

I. Аппарат физиотерапевтический в исполнении МАГ БИО-01, в комплектации:

- Аппарат физиотерапевтический в исполнении: МАГ БИО-01
- Пластина - излучатель – 1 шт.
- Браслет эластичный с контактным электродом – 2 шт.
- Провод соединительный – 2 шт.
- Батарея питания типа АА – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

II. Аппарат физиотерапевтический в исполнении МАГ БИО-02, в комплектации:

- Аппарат физиотерапевтический в исполнении: МАГ БИО-02
- Пластина - излучатель – 1 шт.
- Браслет эластичный с контактным электродом – 2 шт.
- Провод соединительный – 2 шт.
- Батарея питания типа АА – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Руководитель испытаний:



Артемьев А.А.